

RE: Pedido de Esclarecimentos Varian Medical Systems - ID 1009236

CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Qui, 25/07/2024 16:03

Para: Novais, Carolina <carolina.novais@varian.com>

Cc: Mendonca, Fernanda <fernanda.mendonca@varian.com>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Prezados (as),

Segue esclarecimentos da Gerência de Engenharia Clínica (GEENG) e Gerência de Compras (GCOMP).

Quanto ao pedido de esclarecimentos:*"Esclarecemos que a garantia dos equipamentos Varian se inicia após o aceite."***Resposta GEENG:** Sim, lembrando que o aceite se dá apenas após a instalação do equipamento, o seu devido comissionamento e a realização dos treinamentos com a equipe assistencial.*"Esclarecimentos: Informamos que, por se tratar de peças importadas que demandam mais tempo de transporte, solicitamos aprovação para que o prazo de substituição seja de 30 (trinta) dias, diminuindo a chance de ocorrência de atrasos e diminuição de imprevistos."***Resposta GEENG:** O pedido de esclarecimento não menciona se são dias úteis ou corridos, apenas pede que seja de 30 dias. Esclarecemos que casos excepcionais serão analisados caso a caso e poderão ser autorizados a prorrogação do prazo, caso o motivo seja em virtude de casos fortuitos.*"Esclarecemos que, pelo fato de licitarmos com a Varian INC, empresa estrangeira, somente a Varian Medical Systems Brasil, representante legal e nacional, faz a manutenção com seus engenheiros localizados nas principais cidades brasileiras, incluindo o Distrito Federal."***Resposta GEENG:** Sim, entendemos que havendo representante técnico autorizado pela Varian no Território Nacional, estamos de acordo.*"Solicitamos esclarecimentos sobre o pagamento do serviço a ser prestado no período após o prazo de garantia, visando o cenário acima descrito. Ressaltamos que o fornecimento de bens e serviços está coberto durante o período de garantia dos equipamentos e/ou durante a vigência de bens e contratos ativos."***Resposta GEENG:** Essa cláusula se aplica após findada o prazo de garantia de aquisição do equipamento (24 meses), no interstício até o início de um Contrato de Manutenção.*"A Varian esclarece que a empresa oferecerá capacitação para 01 físico por acelerador linear. Tal capacitação hoje é realizada fora do local de instalação do acelerador, porém a aplicação do treinamento estará dependente da política de treinamentos adotada no momento da solicitação, sendo possível o formato híbrido ou e-learning."***Resposta GEENG:** Sim, estamos de acordo.*"A Varian esclarece que o pagamento deverá ser antecipado ao embarque e com pagamento à vista."***Resposta GCOMP:** Sim, conforme o item 16.1 do Edital:

16.1. Os pagamentos serão feitos nos termos previstos no Instrumento Contratual, consoante os preços estabelecidos na proposta de preços, observadas as disposições deste Edital e seus Anexos, de forma antecipada, após o deferimento da Licença de Importação, a emissão da Ordem de fornecimento e a emissão do documento fiscal válido em nome do IGESDF, com todos os campos preenchidos discriminando valor

unitário e total, sem rasuras, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.

"Esclarecimentos: Considerando que tanto para o item 1 (um) quanto para o item 2 (dois) é descrito na seção 1.20 (um ponto vinte), entre outros itens, a necessidade de um Chiller com redundância, a Varian solicita a utilização de dois Chillers, ambos com capacidade de operar dois aceleradores lineares. Um dos Chillers será utilizado como principal, enquanto o outro servirá como redundância para os dois aceleradores lineares disponibilizados para este processo. Desta forma, solicitamos a aprovação para a oferta do quantitativo de dois chillers atendendo ambos aceleradores."

Resposta GEENG: Sim, desde que o chiller tenha na sua configuração capacidade de suprir os 2 (dois) aceleradores lineares e seu sistema de redundância também seja capaz de sustentar o resfriamento de ambos.

"A Varian solicita que seja ofertado 1 (um) No-Break com capacidade para as seis estações do sistema de registro e verificação, ao invés de 1 (um) No-Break para 4 (quatro) estações e outro para 2 (duas) estações."

Resposta GEENG: Sim, desde que esse Nobreak tenha capacidade para suprir a demanda das Workstations sem trabalhar no limite e que o mesmos sejam validados ou homologados pelo fabricante.

Quanto ao complemento do pedido de esclarecimentos:


VARIAN: 1 – Ponto: DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Gostaríamos de esclarecer que a Varian Medical Systems INC, como empresa estrangeira, atua como vendedora e exportadora dos equipamentos ofertados nessa proposta. Todo e qualquer imposto incidente sobre a importação do equipamento é de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR, IMPORTADOR. Ainda, os custos relativos a toda e qualquer licença a ser emitida para fins de instalação, operação e/ou importação dos equipamentos, são de responsabilidade exclusiva do COMPRADOR, IMPORTADOR.

Resposta GCOMP:

Esclarecemos que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF possui as Certidões negativas de débitos, Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social – CEBAS vigente e Habilitação ilimitada para atuação no comércio exterior, emitida pelo Serviço de Fiscalização Aduaneira – SEFIA. Ademais, a contratação de serviços de obra do local de instalação, bem como o processo de licenciamento junto ao CNEN serão de responsabilidade do IGESDF. A Gerência de Compras promoverá a publicação do Edital retificado com ajustes nas informações do item 8.8.1, 8.8.4 e 16.3

Atenciosamente,

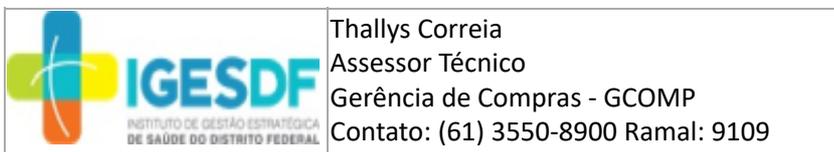

De: Mendonca, Fernanda <fernanda.mendonca@varian.com>

Enviado: segunda-feira, 15 de julho de 2024 14:04

Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Assunto: RES: Pedido de Esclarecimentos Varian Medical Systems - ID 1009236

Boa tarde,

Como ainda não tivemos a resposta, é possível adicionar mais dois esclarecimentos? Apenas dois tópicos que gostaríamos de informar.

[Fernanda Sorato Mendonça](#)

Varian, a Siemens Healthineers company
Av. Beirute, 870 - Cond. Ind Multivias II, Jd Ermida I, Jundiaí 13212-215 Brazil
fernanda.mendonca@varian.com
M +55.11.987416774

varian.com




De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviada em: Monday, July 15, 2024 1:41 PM
Para: Mendonca, Fernanda <fernanda.mendonca@varian.com>
Assunto: RE: Pedido de Esclarecimentos Varian Medical Systems - ID 1009236

Boa tarde.

Prezada Fernanda,
Ainda não houve retorno da área técnica.

Assim que possível, apresentamos os esclarecimentos.

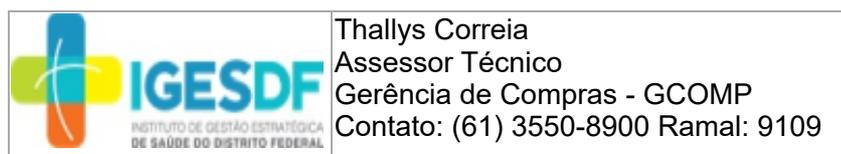

De: Mendonca, Fernanda <fernanda.mendonca@varian.com>
Enviado: segunda-feira, 15 de julho de 2024 13:34
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimentos Varian Medical Systems - ID 1009236

Prezada, boa tarde!

Por gentileza, algum retorno sobre o pedido de esclarecimentos anteriormente enviado?

Aguardo.

Obrigada.

[Fernanda Sorato Mendonça](#)

Varian, a Siemens Healthineers company
Av. Beirute, 870 - Cond. Ind Multivias II, Jd Ermida I, Jundiaí 13212-215 Brazil
fernanda.mendonca@varian.com
M +55.11.987416774

varian.com



De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Enviada em: Thursday, July 11, 2024 3:38 PM

Para: Mendonca, Fernanda <fernanda.mendonca@varian.com>


Cc: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Assunto: RE: Pedido de Esclarecimentos Varian Medical Systems - ID 1009236

Prezada Fernanda,

Informo o recebimento do pedido de esclarecimentos. Assim que possível, retornamos.

Ponho-me à disposição para mais informações.

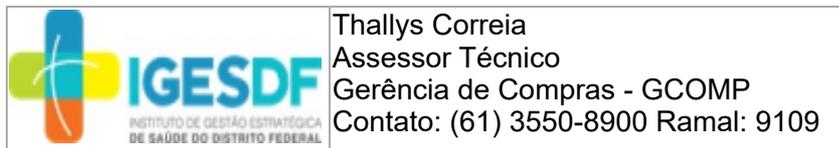

De: Mendonca, Fernanda <fernanda.mendonca@varian.com>

Enviado: quinta-feira, 11 de julho de 2024 15:13

Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Cc: Ferretti, Fernanda <fernanda.ferretti@varian.com>; Cantizani, Karina Gomes <karina.cantizani@varian.com>

Assunto: Pedido de Esclarecimentos Varian Medical Systems - ID 1009236

Boa tarde!

Tudo bem?

Em anexo está o pedido de esclarecimentos da Varian Medical Systems.

Por gentileza, peço que acuse o recebimento deste e-mail.

Obrigada!

Fernanda Sorato Mendonça

Varian, a Siemens Healthineers company

Av. Beirute, 870 - Cond. Ind Multivias II, Jd Ermida I, Jundiaí 13212-215 Brazil

fernanda.mendonca@varian.com

M +55.11.987416774

varian.com

varian
A Siemens Healthineers Company

