Outlook

DÚVIDA SOBRE EDITAL DE IMUNO-HORMÔNIO

De vendasgodf@cqc.com.br <vendasgodf@cqc.com.br>
Data Qua, 08/04/2026 16:05
Para CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>

2 anexos (8 MB)
IMUNO HORMÔNIO - X3, X6 E X8.pdf; EDITAL.pdf;

Boa tarde!

Temos interesse em participar do EDITAL anexo, porém alguns dos nossos reagentes não fazem diluição automática, gostaria de saber se podemos entrar, se vocês aceitam os nossos equipamentos.

Segue anexo folder com os nossos equipamentos.

Estes são os reagentes que os nossos equipamentos não fazem diluição automática:

CA 125

CORTISOL

FSH

INSULINA

LH

PTH

PROGESTERONA

PSA

T4 LIVRE

TESTOSTERONA

TOXO IGG

TOXO IGM

TSH

VITAMINA D

PSA LIVRE

VITAMINA B12

ÁCIDO FÓLICO

Att.

MAGLUMI® X Series

Sistema de imunoensaio de quimioluminescênciatotalmente automático

Equilíbrio e Potência



TECNOLOGIA XCORE —X-TECH

Tecnologia de pipetagem patenteada

Tecnologia de incubação precisa

Tecnologia de Lavagem Inteligente

1 Xpert
Queremos ser especialistas em CLIA

3 Xcellent
Apresentamos excelente desempenho

Projeto de Carregamento de Alta Eficiência

Inside

tech

Tecnologia de medição estável e precisa

2 Xclusive
Aplicamos tecnologia exclusiva

4 Xplore
Nós exploramos o campo desconhecido

Pioneiro na preparaçãoopcional de líquido de lavagem

Fácil de usar com operação fácil e exibição em tempo real

Múltiplas Soluções de Expansão

MAGLUMI® X3

Economize espaço sem comprometê-lo

Compatível com Hospitais e Laboratórios de Pequeno e Médio



200
Tests/Hora

< 0.68m²
Espaço utilizado

72
Posições de amostras

20
Posições de reagentes

80
Posições de incubação

Pequeno porém potente

- O Rendimento por unidade/area é de 294 T/h/m²
- Compatível com todos os reagentes**MAGLUMI®** (236 parameters)

Baixa taxa de falha e resultado preciso

- A cubeta de reação pode evitar a poluição the luminosa, garantindo a precisão dos resultados
- Embalagem integradas de cubetas paraevitar o bloqueio, arranhões e travamentos
- Agulha de pipetagem revestida com TEFLON, equipado com unidade de lavagem independente para evitar o arraste,garantindo resultados precisos

Excelente performance

- O design compreensivo do **MAGLUMI®** X3 assegura a excelente performance, como a mais recente tecnologia delavagem inteligente e medição de controle de temperatura bidirecional

Praticidade e alta eficiência

- Carregamento/descarregamento sem pausa de reagentes/amostras/cubetas de reaçãoor sem esperar ou interromper os testes
- As luzes indicadoras intuitivas dispensam verificação frequente de reagentes e consumíveis

Econômico e inteligente

- Economiza custos com consumíveis por não utilizar ponteiras descartáveis
- Agulha de pipetagem com três tecnologias dedetecção de erro (nível de líquido/coágulo/ crash), reduzindo a taxa de erro

MAGLUMI® X6

Combinação flexível atendendo a várias necessidades

Direcionado para laboratório de tamanho médio/grande



450
Tests/Hoar

2000
Autonomia "walk-away"

112/412
Posições de amostras

30
Posições de reagentes

243
Posições de incubação

Rápido e econômico

- 450 T/H com tamanho médio, adequado para laboratório de médio ou alto volume
- Compativel com todos os reagentes **MAGLUMI®** (236 parameters)

Praticidade e alta eficiência

- Sem pausa para carregar/descarregar reagentes /amostras/consumiveis sem interromper os testes
- Operação única e unilateral, economizando espaço e etapas
- Serviço inteligente remoto **SnibeLinker®** para garantir a resposta rápida

Combinação flexível de acordo com os requisitos

- Posições de amostra adicionais disponíveis que podem ser expandidas para 412
- Capaz de vincular o Sistema Total de Automação Laboratorial (TLA)

Design amigável

- Autonomia de até 2000 testes para evitar altafrequência de intervenção manual
- Preparação de líquido de lavagem em modo duplo - automática ou manual
- Interface de interface do usuário inteligente, operação amigável, fácil e conveniente

Função avançada e precisa

- Um volume de pipetagem revolucionário de 10 µL a 280 µL com maior precisão e baixo CV de pipetagem
- Quatro tipos de tecnologias de detecção de erro de pipetagem

MAGLUMI® X8

Solução CLIA de alto Rendimento

Direcionado para grandes laboratórios, cadeias de laboratórios e hospitais



600
Testes/Hora

2800
Autonomia "walk-away"

300
Posições de amostras

42
Posições de reagentes

252
Posições de incubação

Excellent performance

- Um dos analisadores CLIA mais rápidos com 600 T/H (módulo único)
- Até 2400 T/H (quatro módulos combinados)
- Compativel com todos os reagentes **MAGLUMI®** (236 parameters)

Economiza mão de obra

- Longo tempo de afastamento - 2800 testes, economizando muito o trabalho humano
- Carregamento de 2.912 cubetas de uma só vez com carregador de cubetas completo, sem necessidade de adicionar frequentemente

Inteligência avançada

- Capaz de se conectar com o sistema de automação de laboratório (TLA/LAS)
- Capaz de integrar com o **Biossays®** C8 (analisador bioquímico de alto rendimento) eo módulo decapper

Design atencioso

- Luzes indicadoras multidimensionais,monitoramento em tempo real do status do analisador à distância
- Preparação de líquido de lavagem em modo duplo automático ou manual
- Placa de cobertura de reagente automática e modode temperatura dupla reduzindo a volatilização doreagente e aumentando a estabilidade dos kits dereagentes on board

Convenient operation

- Interface amigável, operação fácil e conveniente
- Sem pausa para carregar/descarregar reagentes/amostras/consumiveis sem interromper os testes

Tecnologias de destaque — X-tech

Tecnologia avançada de pipetagem *



Tecnologia de pipetagem para amostras

- Uma tecnologia de pipetagem revolucionária com volume altamente preciso, garantindo resultados confiáveis
- Quatro tipos de tecnologias de detecção de erro de pipetagem (nível de líquido/coágulo/bolha/ detecção de colisão) reduzindo a taxa de erro



Ponteiras descartáveis filtradas

- Embalagem integrada de ponteiras filtradas para descarte, garantindo nenhuma contaminação cruzada e baixa taxa de falhas, evitando a poluição por aerossóis
- Tecnologia de pipetagem única para vários testes, reduzindo o tempo de teste e o custo das ponteiras

Tecnologia de incubação precisa






- Mistura sem contato
  Antes da incubação, a mistura sem contato com diferentes modos garante reação suficiente
- Incubação precisa
  Design de cubeta única para cada teste com aquecimento de incubação de pelo menos cinco lados (X8 é 360°) a 37±0,3℃, torna a incubação precisa, rápida e uniforme

* Para X6 and X8

Tecnologias de destaque — X-tech


Exclusiva tecnologia de lavagem inteligente

Unidades de lavagem independentes para agulhas de resíduos líquidos

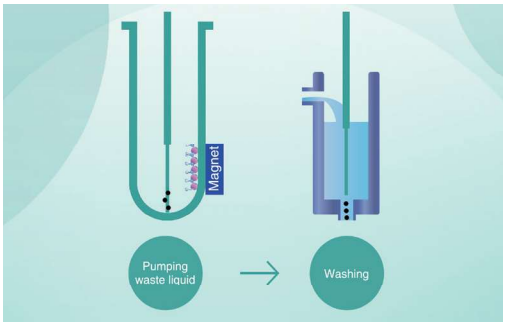

Na estação de lavagem, quatro agulhas de resíduos líquidos são equipadas com quatro unidades de lavagem independentes para evitar o arraste.


Lavagem por separação magnética e mistura em vórtice sem contato

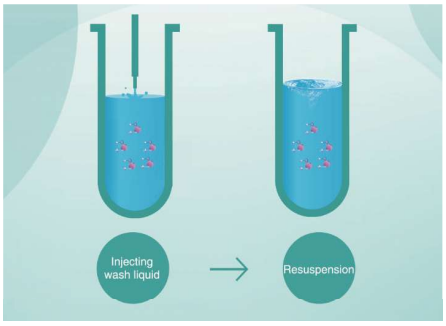





Lavagem por separação magnética e unidades de mistura de vórtice sem contato, com diferentes modos de mistura dependendo dos diferentes ensaios, garantindo uma lavagem suficiente para reduzir a ligação não específica.

Câmara de medição estável e precisa

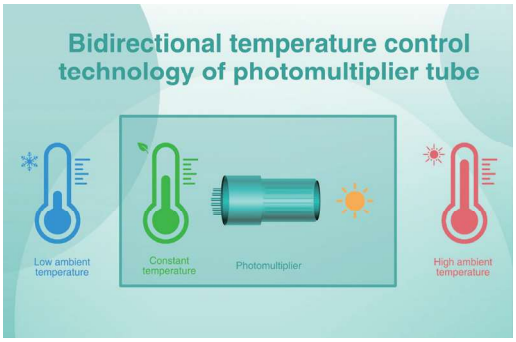



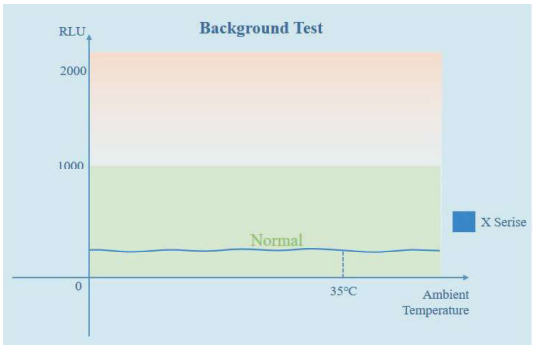


O controle automático de temperatura na câmara de medicão pode manter um valor de fundo estável, nãoafetado pela temperatura ambiente, garantindo a precisão dos resultados da medição.

Tecnologias de destaque — X-tech

Pioneiro na preparação opcional de líquido de lavagem *

Preparação de líquido de lavagem em modo duplo - Automático ou Manual

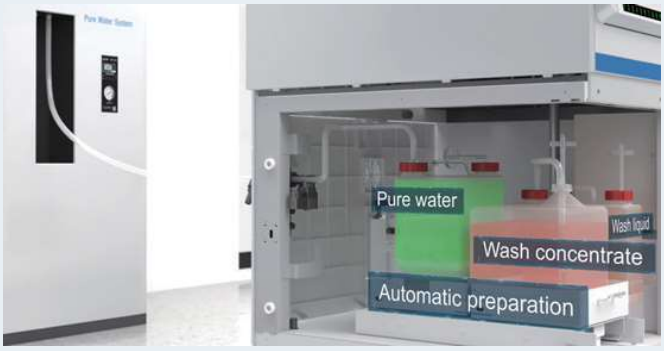




- Selecione o modo Auto no software, conecte o X6/X8 ao sistema de purificação de água, minimize sua carga operacional
- Se o sistema de purificação de água não estiver disponível, a preparação pode ser feita misturando manualmente o liquido de lavagem com água pura

Soluções flexíveis de expansão *





- Mesmos módulos combinados com alto rendimento e pequena ocupação de espaço
- Capaz de integrar com **Biossays**® C8 (analisador bioquímico de alto rendimento)
- Capaz de se conectar com o módulo decapper

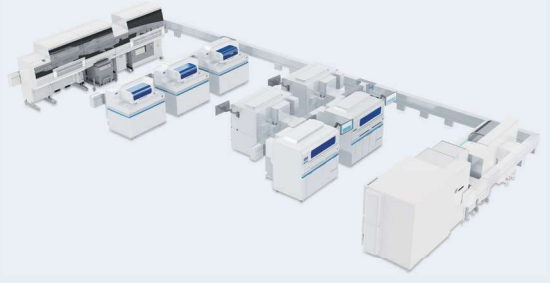



- Capaz de se conectar com o sistema de automação de laboratório (TLA/LAS)

* Para X6 and X8

Principais tecnologias

O CLIA usa duas tecnologias importantes, uma é a tecnologia do marcação, que determina o modo de reação e a outra é uma tecnologia de separação, que determina a sensibilidade, exatidão e precisão dos reagentes.


Tecnologia do marcação

O sistema **MAGLUMI®** aplica marcação ABEI. ABEI é uma pequena molécula não enzimática com fórmula molecular especial para aumentar a estabilidade em tampão ácido e alcalino.Usando quimiluminescência rápida,a reação química do ABEI com hidróxido de sódio (NaOH) e peróxido (H2O2) finaliza o processo em 3 segundos.

Tecnologia de Separação

MAGLUMI® usa microesferas magnéticas.Como tecnologiade separação,tem sido amplamente utilizada na área de CLIA. Comparado com a tecnologia de separação tradicional,tem as seguintes vantagens:

- Redução do tempo de reação aumentando a área de reação de antígenos e anticorpos.
- Melhorar a sensibilidade pela captura melhor e maisrápida de antígenos e anticorpos.
- Reduzir significativamente as discrepâncias inter ou intra-ensaio misturando os reagentes completamente em uma plataforma de separação de líquidos.
- Melhorara precisão absorvendo antígenos e anticorpo por meio de reação química.

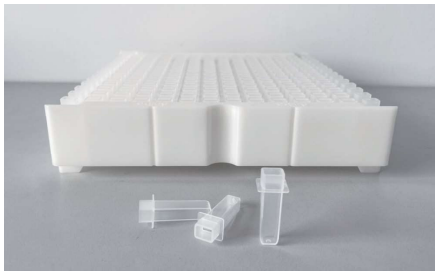

Cubetas de reação



Ponteiras descartáveis



Starter 1+2



Wash Concentrate



Solução de limpeza de tubulação



Light Check

Amplo Menu de Testes CLIA com 236 Testes

Tiróide

- TSH (3rd Geração) FDA
- T4 FDA
- T3 FDA
- FT4 FDA
- FT3 FDA
- Tg (Tireoglobulina)
- TGA (Anti-Tg)
- Anti-TPO
- TRAb
- TMA
- Rev T3
- T-Uptake

Metabolismo Ósseo

- Calcitonina
- Osteocalcina
- *PTH (1-84)
- 25-OH Vitamina D FDA
- PTH Intacta
- β-CTx
- P1NP total

Fibrose Hepática

- HA
- PIIIP N-P
- C IV
- Laminina
- P1NP total
- GP73

Imunoglobulinas

- IgM
- IgA
- IgE
- IgG

Glico Metabolismo

- Peptídeo-C
- Insulin
- GAD 65
- Anti-IA2
- ICA
- IAA (Anti Insulin)
- Proinsulina
- *Glucagon
- *Anti-ZnT8

Marcadores Tumorais

- AFP
- CEA
- PSA Total
- PSA livre
- CA 125
- CA 15-3
- CA 19-9
- PAP
- CA 50
- CYFRA 21-1
- CA 242
- CA 72-4
- NSE
- S-100
- SCCA
- TPA-snibe
- ProGRP
- HE4
- HER-2
- PIVKA-II
- *AFP-L3%

Anemia

- Vitamina B12
- Ferritina
- Folato (FA)
- EPO
- Folate RBC
- *Fator Anti-Intrínsico
- *B12 Ativa

STAT-X™

- *hs-cTnI STAT-X™
- *Myoglobina STAT-X™
- *PCT STAT-X™
- *NT-proBNP STAT-X™
- *D-Dímero STAT-X™
- *CRP STAT-X™

Hipertensão

- Renina Direta
- Aldosterone
- Angiotensina I
- Angiotensina II
- Cortisol
- ACTH

Fertilidade

- FSH
- LH
- HCG/β-HCG FDA
- PRL (Prolactina)
- Estradiol
- Testosterona
- Testosterone Livre
- DHEA-S
- Progesterona
- Estriol Livre
- 17-OH Progesterona
- AMH
- SHBG
- Androstenediona
- PIGF
- sFlt-1
- *Inhibina A
- *Inhibina B

Doenças Infecciosas

Respiratórias

- 2019-nCoV IgG
- 2019-nCoV IgM
- SARS-CoV-2 S-RBD IgG
- SARS-CoV-2 Anticorpo Neutralizante
- SARS-CoV-2 Ag
- *Mycoplasma Pneumoniae* IgG
- *Mycoplasma Pneumoniae* IgM
- **Chlamydia Pneumoniae* IgG
- **Chlamydia Pneumoniae* IgM
- *Vírus respiratório sincicial IgM
- *Coxsackievirus B IgM
- *Adenovirus IgM
- *Influenza A Virus IgM
- *Influenza B Virus IgM
- *Legionella Pneumophila IgM
- *Human Parainfluenza Virus IgM

Hepatites

- HBsAg
- Anti-HBs
- HBeAg
- Anti-HBe
- Anti-HBc
- Anti-HBc IgM
- Anti-HCV
- Anti-HAV
- HAV IgM
- *HBV Pre-S1 Ag
- *HEV IgG
- *HEV IgM

Outros

- HIV Ab/Ag Combo
- Sífilis
- Chagas
- HTLV I+II
- H.pylori IgG
- H.pylori IgA
- H.pylori IgM
- *H.pylori Ag
- Dengue IgG
- Dengue NS1
- *Dengue IgM
- Monkeypox Ag

TORCH

- Toxo IgG
- Toxo IgM
- Rubella IgG
- Rubella IgM
- CMV IgG
- CMV IgM
- HSV-1/2 IgG
- HSV-1/2 IgM
- HSV-1 IgG
- HSV-2 IgG
- *HSV-2 IgM
- *HSV-1 IgM
- *Toxo IgG Avidez
- *CMV IgG Avidez

EBV

- EBV VCA IgG
- EBV VCA IgM
- EBV VCA IgA
- EBV EA IgG
- EBV EA IgA
- EBV NA IgG
- EBV NA IgA

Triagem Pré-natal

- AFP (Triagem Pré-natal)
- Estriol livre
- β-HCG livre
- PAPP-A
- *Inhibina A

Cardíacos

- CK-MB
- Troponina I
- Myoglobina
- hs-cTnI
- hs-CRP
- H-FABP
- NT-proBNP
- BNP
- *D -Dímero
- Lp-PLA2
- MPO
- HCY
- *sST2
- *hs-cTnI STAT-X™
- *NT-proBNP STAT-X™
- *Myoglobina STAT-X™
- *D-Dímero STAT-X™

Autoimunidade

Doença do Tecido Conectivo

- ANA Screen
- ENA Screen
- Anti-dsDNA IgG
- Anti-Sm IgG
- Anti-Rib-P IgG
- Anti-SS-B IgG
- Anti-SS-A IgG
- Anti-Jo-1 IgG
- Anti-Scl-70 IgG
- Anti-centrômeros IgG
- Anti-histonas IgG
- Anti-nRNP/Sm IgG
- *Anti-Ro-52 IgG
- *Anti-PM-Scl IgG
- *Anti-Nucleosome IgG

Artrite Reumatoide

- Anti-CCP
- *RF IgM
- *RF IgG
- *RF IgA
- *RF Screen

Doença Celíaca

- Anti-tTG IgA
- Anti-tTG IgG
- DGP IgA
- DGP IgG

Doença Autoimmune do Fígado

- Anti-M2-3E IgG

Endocrinologia

- Anti-TPO
- TGA (Anti-Tg)
- TRAb
- TMA
- GAD 65
- Anti-IA2
- ICA
- IAA (Anti Insulina)
- *Anti-ZnT8

Vasculites

- Anti-MPO IgG
- *Anti-PR3 IgG
- *Anti-GBM IgG

Síndrome Antifosfolipídica

- Anti-Cardiolipina IgG
- Anti-Cardiolipina IgM
- *Anti-Cardiolipina IgA
- *Anti-Cardiolipina Screen
- β2-Glycoproteina I IgG
- β2-Glycoproteina I IgM
- *β2-Glycoproteina I IgA
- *β2-Glycoproteina I screen

Monitoramento Inflamatório

- CRP
- PCT (Procalcitonina)
- TNF-α
- IL-6 (Interleucina 6)
- SAA (Soro Amiloide A)
- *VEGF
- *PCT STAT-X™
- *CRP STAT-X™

Metabolismo

- Pepsinogênio I
- Pepsinogênio II
- Gastrina-17
- GH (hGH)
- IGF-I
- IGFBP-3

Função Renal

- β_2-MG
- Albumina
- *NGAL

Monitoramento de Drogas

- Digoxina
- CSA (Ciclosporina A)
- FK 506 (Tacrolimus)

Monitoramento de Drogas

- D-Dímero
- TAT
- TM
- PIC
- tPAIC
- *FDP

Testagem Veterinária

- *cTSH
- *cTT4
- *vFT4

*Disponível em breve



MAGLUMI® , **Biossays®** and **SnibeLinker®** are trademarks of Snibe.
All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

Snibe Diagnostic

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.
(SNIBE Co.,Ltd.)
No.23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen,
P.R. China

Tel: +86 755 26501514
Fax: +86 755 26654850
Email: sales@snibe.com
Web: www.snibe.com

Follow us on

M5055E01-20230725