Barueri, 13 de maio de 2026.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

NÚCLEO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIZADO

E-mail: emendas.propostas@igesdf.org.br

EDITAL Nº 32/2026

DATA DA ABERTURA: DIA 25/05/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X FIXO E MÓVEL

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.752.460/0001-56, localizada na Av. Tamboré nº 576 – Barueri/SP – CEP 06.460-000, interessada em participar do processo em referência, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** a respeito do **EDITAL N° 32/26**, conforme questionamentos apresentados ao longo desse documento.

SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL FIXO E ITEM 02 – APARELHO DE RAIOS -X DIGITAL MÓVEL

Solicitamos esclarecimentos a respeito da possibilidade de alterar as especificações técnicas solicitadas em edital, de acordo com as sugestões abaixo:

Ressaltamos que, realizando as alterações técnicas aqui sugerida, o edital permitirá a participação de várias empresas ofertando aparelhos médicos com alta qualidade e a mais moderna tecnologia existente para radiologia, entre elas a SHIMADZU, fazendo com que o **INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**, adquiram equipamentos robustos, com ótima qualidade de exames.

ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL FIXO	
O EDITAL SOLICITA	**SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO**
1.6.5. Rotação da coluna maior ou igual a 180°	**SUGERIMOS EXCLUIR:** 1.6.5. Rotação da coluna maior ou igual a 180°
1.9.11. DQE (Detective Quantum Efficiency) maior ou igual a 65% em 0 lp/mm	**SUGERIMOS ALTERAR PARA:** 1.9.11. DQE (Detective Quantum Efficiency) maior ou igual a 45% em 0 lp/mm

1.11.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior, monocromático e recalibrável	**SUGERIMOS ALTERAR PARA:** 1.11.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior e calibrável
1.11.5. Conjunto de mouse e teclado para área médica	**SUGERIMOS ALTERAR:** 1.11.5. Conjunto de mouse e teclado comum

ITEM 02 – APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL MÓVEL	
O EDITAL SOLICITA	**SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO**
1.1.1. Equipamento de radiologia digital móvel com aquisição direta da imagem através de detector com tecnologia DR para diversas aplicações, permitindo a realização de exames radiológicos de todo o corpo, inclusive em posições laterais, livres e exames de coluna completa	**SUGERIMOS EXCLUIR:** exames de coluna completa
1.3.7. Modos de operação: manual, automático e pediátrico	**SUGERIMOS EXCLUIR:** Modos automático e pediátrico
1.6.2. Coluna articulada com movimento vertical e horizontal	**SUGERIMOS ALTERAR PARA:** 1.6.2. Coluna articulada com movimento vertical, horizontal ou telescópica
1.8.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior	**SUGERIMOS ALTERAR PARA:** 1.8.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 1.3 megapixels de resolução, ou superior
1.8.3. Disco rígido maior ou igual a 1 TB	**SUGERIMOS ALTERAR PARA:** 1.8.3. Disco rígido de 240GB ou maior
1.8.4. Memória RAM maior ou igual a 8GB	**SUGERIMOS ALTERAR PARA:** 1.8.4. Memória RAM maior ou igual a 4GB
1.8.7.3. Junção automática ou manual de exames panorâmicos obrigatória	**SUGERIMOS EXCLUIR:** *1.8.7.3. Junção automática ou manual de exames panorâmicos obrigatória, pois o* aparelho de raios-X móvel, é utilizado para exames de pacientes em leitos, UTI e emergências, ou seja, não é utilizado para exames gerais como radiografia de coluna total ou escanometria, exames que são realizados em aparelhos de Raios-X fixos.
1.8.7.4. Exportação JPEG para CD/DVD/USB	**SUGERIMOS ALTERAR PARA:** 1.8.7.4. Exportação para USB
1.9.2. 02 (dois) detectores wireless compatíveis com as características técnicas especificadas	**ESCLARECIMENTO:** O descritivo técnico fala somente um detector, por favor, esclarecer devemos ofertar uma ou duas unidades.

Salientamos que a SHIMADZU prioriza o bom relacionamento com seus clientes, buscando sempre a excelência nos serviços prestados, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA
YUJI KUNII
Diretor Sênior
RNM Nº B118178-3 DIREX/DPF/SP
CPF Nº 121.279.311-06

Outlook

EDITAL Nº 32/2026 - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO - SHIMADUZ DO BRASIL

De Elaine Cristina Rodrigues Brito <elaine@shimadzu.com.br>
Data Qua, 13/05/2026 11:06
Para CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Cc Juliana Gomes Ribeiro Boldorini <juliana.ribeiro@shimadzu.com.br>; Djan Valias <djanvalias@shimadzu.com.br>; Michele Laudadio Duarte <michele.duarte@shimadzu.com.br>

1 anexo (171 KB)
IGESDF (EDITAL 032-2026) RX FIXO E MOVEL DIGITAL.pdf;

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
NÚCLEO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIZADO
E-mail: emendas.propostas@igesdf.org.br


EDITAL Nº 32/2026
DATA DA ABERTURA: DIA 25/05/2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X FIXO E MÓVEL

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.752.460/0001-56, localizada na Av. Tamboré nº 576 – Barueri/SP – CEP 06.460-000, interessada em participar do processo em referência, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** a respeito do **EDITAL N° 32/26**, conforme questionamentos apresentados no oficio em anexo.

Por favor, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Elaine Brito
Coordenadora de Licitações
Divisão Médica | Departamento Comercial
Shimadzu do Brasil Comércio Ltda.
Direto: +55 11 2424-1757
elaine@shimadzu.com.br | www.shimadzu.com.br

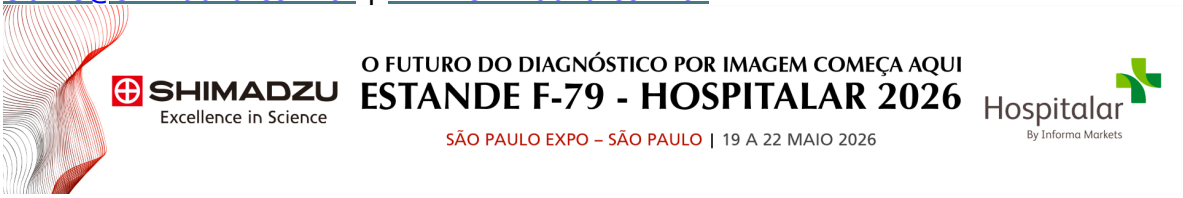

Outlook

RE: IGESDF - EDITAL Nº 32/2026 - ID 1522880 | PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO | APARELHOS DE RAIO-X

De CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Data Qua, 08/07/2026 14:40
Para Juliana Gomes Ribeiro Boldorini <juliana.ribeiro@shimadzu.com.br>; vendas.medica@shimadzu.com.br <vendas.medica@shimadzu.com.br>

Prezado Fornecedor,

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao Edital nº32/2026, para aquisição de **Aparelhos de Raio-x Fixo e Móvel**, informamos que a demanda foi analisada pela área técnica.

ANÁLISE TÉCNICA

Empresa SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA (Doc. SEI n.º 202911345)

DA TEMPESTIVIDADE:

- Considerando o edital, informa-se que o pedido de esclarecimentos e impugnação do edital foi acolhido tempestivamente, datado de 13 de maio de 2026, por estar dentro do prazo.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO:

ITEM 1: APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL FIXO:

Características Técnicas:

- 1.6.5. Rotação da coluna maior ou igual a 180°.
- 1.9.11. DQE (Detective Quantum Efficiency) maior ou igual a 65% em 0 lp/mm.
- 1.11.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior, monocromático e recalibrável.
- 1.11.5. Conjunto de mouse e teclado para área médica.

Pretensão da empresa licitante:

Solicitação de exclusão/alteração dos seguintes itens:

- 1.6.5. Rotação da coluna maior ou igual a 180°.
- 1.9.11. DQE (Detective Quantum Efficiency) maior ou igual a 45% em 0 lp/mm.
- 1.11.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior e calibrável.
- 1.11.5. Conjunto de mouse e teclado comum.

Julgamento: **INDEFERIDOS.**

Análise Técnica:

As sugestões carecem de argumentação técnica substancial que justifiquem as exclusões ou redimensionamento das especificações. A análise técnica evidencia que as solicitações configuram sucessivas tentativas de rebaixamento da qualidade da especificação técnica mínima, comprometendo a adequação funcional do equipamento às demandas operacionais da instituição.

Ressalta-se que o IGESDF, enquanto gestor de saúde do segundo maior complexo hospitalar público do Distrito Federal, possui necessidades técnicas específicas que demandam equipamentos com capacidades operacionais robustas. Os requisitos visam:

- Versatilidade de posicionamento do paciente;

- Eficiência operacional em ambiente de alta demanda.

Conclusão: As especificações técnicas do edital estão fundamentadas em necessidades operacionais reais da instituição. **Opina-se pelo INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS/SUGESTÕES**. As especificações **MANTÉM-SE INALTERADAS em:**

- Item 1.6.5. - **Rotação da coluna maior ou igual a 180°.**
- Item 1.9.11. - **DQE (Detective Quantum Efficiency) maior ou igual a 65% em 0 lp/mm.**
- Item 1.11.1. - **Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior, monocromático e recalibrável.**
- Item 1.11.5. - **Conjunto de mouse e teclado para área médica.**

ITEM 2: APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL MÓVEL:

Características Técnicas:

- 1.1.1. Equipamento de radiologia digital móvel com aquisição direta da imagem através de detector com tecnologia DR para diversas aplicações, permitindo a realização de exames radiológicos de todo o corpo, inclusive em posições laterais, livres e exames de coluna completa.
- 1.3.7. Modos de operação: manual, automático e pediátrico.
- 1.6.2. Coluna articulada com movimento vertical e horizontal.
- 1.8.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior.
- 1.8.3. Disco rígido maior ou igual a 1 TB.
- 1.8.4. Memória RAM maior ou igual a 8GB.
- 1.8.7.3. Junção automática ou manual de exames panorâmicos obrigatória.
- 1.8.7.4. Exportação JPEG para CD/DVD/USB.
- 1.9.2. 02 (dois) detectores wireless compatíveis com as características técnicas especificadas.

Pretensões da empresa licitante:

Solicitação de exclusão/alteração/esclarecimento dos seguintes itens:

- Item 1.1.1.: Exclusão da capacidade de exames de coluna completa.
- Item 1.3.7.: Exclusão dos modos automático e pediátrico.
- Item 1.6.2.: Alterar para: coluna articulada com movimento vertical, horizontal ou telescópica.
- Item 1.8.1.: Alterar para: Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 1.3 megapixels de resolução, ou superior.
- Item 1.8.3.: Alterar para: Disco rígido de 240GB ou maior.
- Item 1.8.4.: Alterar para: Memória RAM maior ou igual a 4GB.
- Item 1.8.7.3.: Exclusão do item.
- Item 1.8.7.4.: Alterar para: Exportação para USB.
- Item 1.9.2.: Esclarecimento: O descritivo técnico fala somente um detector, por favor, esclarecer devemos ofertar uma ou duas unidades.

Julgamento: **INDEFERIDOS.**

Análise Técnica:

As sugestões carecem de argumentação técnica substancial que justifiquem as exclusões ou redimensionamento das especificações. A análise técnica evidencia que as solicitações configuram sucessivas tentativas de rebaixamento da qualidade da especificação técnica mínima, comprometendo a adequação funcional do equipamento às demandas operacionais da instituição. Quantos aos detectores são dois conforme item 1.9.2..

Ressalta-se que o IGESDF, enquanto gestor de saúde do segundo maior complexo hospitalar público do Distrito Federal, possui necessidades técnicas específicas que demandam

equipamentos com capacidades operacionais robustas. Os requisitos visam:

- Versatilidade de posicionamento do paciente;
- Eficiência operacional em ambiente de alta demanda.

Conclusão: As especificações técnicas do edital estão fundamentadas em necessidades operacionais reais da instituição. **Opina-se pelo INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS/SUGESTÕES**. As especificações **MANTÉM-SE INALTERADAS em:**

- Item 1.1.1. - **Equipamento de radiologia digital móvel com aquisição direta da imagem através de detector com tecnologia DR para diversas aplicações, permitindo a realização de exames radiológicos de todo o corpo, inclusive em posições laterais, livres e exames de coluna completa.**
- Item 1.3.7. - **Modos de operação: manual, automático e pediátrico.**
- Item 1.6.2. - **Coluna articulada com movimento vertical e horizontal.**
- Item 1.8.1. - **Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior.**
- Item 1.8.3. - **Disco rígido maior ou igual a 1 TB.**
- Item 1.8.4. - **Memória RAM maior ou igual a 8GB.**
- Item 1.8.7.3. - **Junção automática ou manual de exames panorâmicos obrigatória.**
- Item 1.8.7.4. - **Exportação JPEG para CD/DVD/USB.**
- Item 1.9.2. - **02 (dois) detectores wireless compatíveis com as características técnicas especificadas.**

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Equipe de Aquisições - Emendas Parlamentares
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
Gerência de Compras de Equipamentos e Imobilizado - GECEI
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 R

De: Elaine Cristina Rodrigues Brito <elaine@shimadzu.com.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2026 14:34
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Assunto: Resposta automática: IGESDF - EDITAL Nº 32/2026 - ID 1522880 | PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO | APARELHOS DE RAIO-X

Informo que estarei de férias no período de 19/01/2026 à 02/02/2026.
Por favor, entrar em contato com Juliana no telefone (011) 2424-1759 - E-mail juliana.ribeiro@shimadzu.com.br ou vendas.medica@shimadzu.com.br.
Atenciosamente,