Outlook

RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

De CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Data Qua, 23/09/2026 15:23
Para Narjara Bravin <narjara.bravin@bbraun.com>
Cc lidson.carvalho@bbraun.com <lidson.carvalho@bbraun.com>; suporteaocliente@bbraun.com <suporteaocliente@bbraun.com>; vendasdigitais.br@bbraun.com <vendasdigitais.br@bbraun.com>; vanessa.paula@bbraun.br <vanessa.paula@bbraun.br>

Prezados,

Referente ao processo de aquisição em andamento e conforme a análise técnica, a área de planejamento solicitou diligência junto aos fornecedores, para que apresentem documentação técnica e/ou declaração formal da empresa fabricante, de forma clara e objetiva, comprovando o atendimento aos requisitos abaixo:

> *À empresa **B. BRAUN**, referente à **bomba Infusomat Compactplus**: apresentar comprovação técnica quanto à existência e ao funcionamento dos alarmes de segurança exigidos nas especificações do processo.*
>
> *Ressalta-se que as respostas deverão ser apresentadas de forma objetiva, acompanhadas, de documentação técnica do fabricante, manuais, fichas técnicas, catálogos ou declaração formal que permita a verificação inequívoca do atendimento aos requisitos estabelecidos.*

A comprovação deverá ser enviada impreterivelmente até o dia 24/09/2026


Grata,

De: Narjara Bravin <narjara.bravin@bbraun.com>
Enviado: terça-feira, 15 de setembro de 2026 16:35
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>; Isaias Santos <isaias.santos@bbraun.com>
Cc: Lidson Araujo <lidson.carvalho@bbraun.com>; Suporte_Cliente <suporteaocliente@bbraun.com>; Vendas_Digitais_BR <vendasdigitais.br@bbraun.com>; vanessa.paula@bbraun.br <vanessa.paula@bbraun.br>
Assunto: RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Boa Tarde a todos,
Espero encontrá-los bem.

Em continuidade à diligência anteriormente encaminhada no âmbito do Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31, referente à Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato, encaminham-se, conforme solicitação da Gerência de Engenharia Clínica, os pontos que permanecem para complementação na proposta da B. Braun – modelo Infusomat compactplus, após análise seguem respostas da diligência:

Item 5 – Calibração/validação de fábrica
Solicita-se complementar a comprovação quanto à calibração e/ou validação de fábrica do equipamento.
Resposta: Em todo equipamento Bbraun, individualmente, acompanha conforme abaixo (foto) o CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, advindo de fábrica.

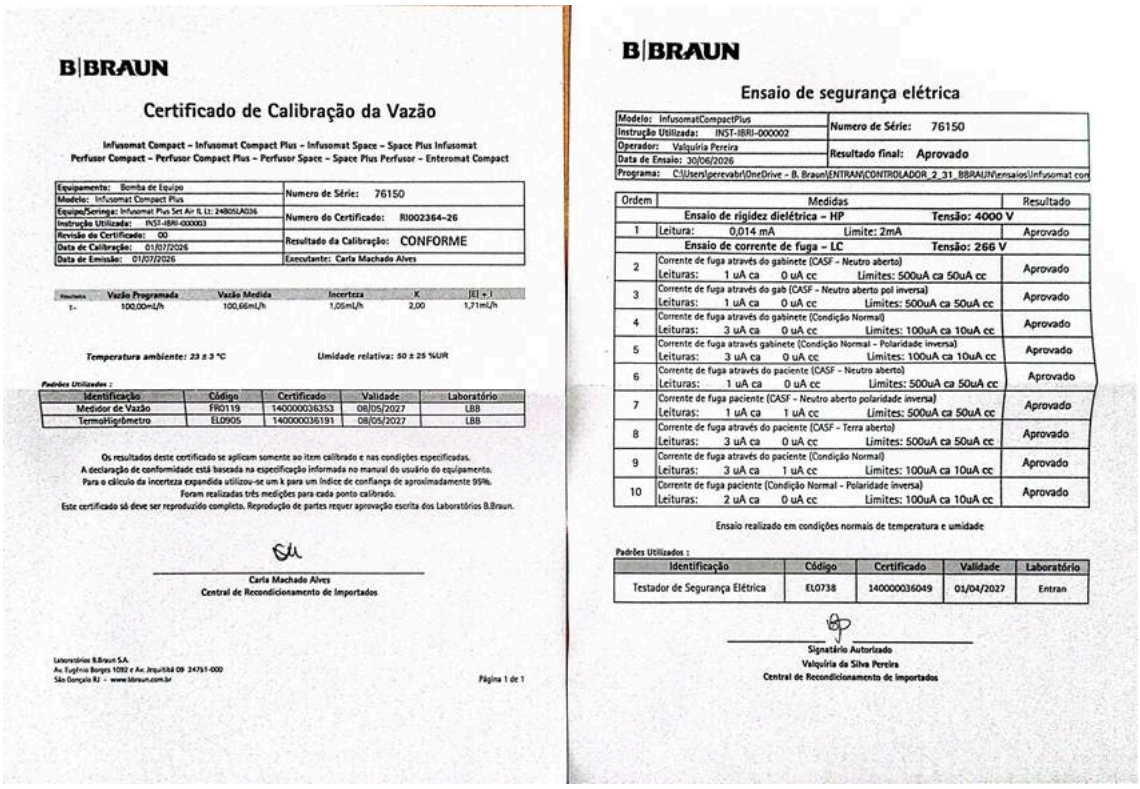

B|BRAUN

Certificado de Calibração da Vazão

Infusomat Compact – Infusomat Compact Plus – Infusomat Space – Space Plus Infusomat
Perfusor Compact – Perfusor Compact Plus – Perfusor Space – Space Plus Perfusor – Enteromat Compact

Equipamento: Bomba de Equipo	Numero de Série: 76150
Modelo: Infusomat Compact Plus	
Equipo/Seringa: Infusomat Plus Set Air IL Lt: 24805LA036	Numero do Certificado: RI002364-26
Instrução Utilizada: INST-IBRI-000003	
Revisão do Certificado: 00	Resultado da Calibração: CONFORME
Data de Calibração: 01/07/2026	
Data de Emissão: 01/07/2026	Executante: Carla Machado Alves

Ponto/Nº	Vazão Programada	Vazão Medida	Incerteza	K	|EI + I|
1.-	100,00mL/h	100,66mL/h	1,05mL/h	2,00	1,71mL/h

Temperatura ambiente: 23 ± 3 °C Umidade relativa: 50 ± 25 %UR

Padrões Utilizados :

Identificação	Código	Certificado	Validade	Laboratório
Medidor de Vazão	FR0119	1400000036353	08/05/2027	LBB
TermoHigrômetro	EL0905	1400000036191	08/05/2027	LBB

Os resultados deste certificado se aplicam somente ao item calibrado e nas condições especificadas.
A declaração de conformidade está baseada na especificação informada no manual do usuário do equipamento.
Para o cálculo da incerteza expandida utilizou-se um k para um índice de confiança de aproximadamente 95%.
Foram realizadas três medições para cada ponto calibrado.
Este certificado só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita dos Laboratórios B.Braun.

Carla Machado Alves
Central de Recondicionamento de Importados

Laboratórios B.Braun S.A.
Av. Eugênio Borges 1080 e Av. Jequitibá 09 24751-000
São Gonçalo RJ - www.bbraun.com.br

Página 1 de 1

B|BRAUN

Ensaio de segurança elétrica

Modelo: InfusomatCompactPlus	Numero de Série: 76150
Instrução Utilizada: INST-IBRI-000002	
Operador: Valquíria Pereira	Resultado final: Aprovado
Data de Ensaio: 30/06/2026	
Programa: C:\Users\perevabr\OneDrive - B. Braun\ENTRAN\CONTROLADOR_2_31_BBRAUN\ensaios\Infusomat com	

Ordem	Medidas	Resultado
	Ensaio de rigidez dielétrica – HP Tensão: 4000 V	
1	Leitura: 0,014 mA Limite: 2mA	Aprovado
	Ensaio de corrente de fuga – LC Tensão: 266 V	
2	Corrente de fuga através do gabinete (CASF - Neutro aberto) Leituras: 1 uA ca 0 uA cc Limites: 500uA ca 50uA cc	Aprovado
3	Corrente de fuga através do gab (CASF - Neutro aberto pol inversa) Leituras: 1 uA ca 0 uA cc Limites: 500uA ca 50uA cc	Aprovado
4	Corrente de fuga através do gabinete (Condição Normal) Leituras: 3 uA ca 0 uA cc Limites: 100uA ca 10uA cc	Aprovado
5	Corrente de fuga através gabinete (Condição Normal - Polaridade inversa) Leituras: 3 uA ca 0 uA cc Limites: 100uA ca 10uA cc	Aprovado
6	Corrente de fuga através do paciente (CASF - Neutro aberto) Leituras: 1 uA ca 0 uA cc Limites: 500uA ca 50uA cc	Aprovado
7	Corrente de fuga paciente (CASF - Neutro aberto polaridade inversa) Leituras: 1 uA ca 1 uA cc Limites: 500uA ca 50uA cc	Aprovado
8	Corrente de fuga através do paciente (CASF - Terra aberto) Leituras: 3 uA ca 0 uA cc Limites: 500uA ca 50uA cc	Aprovado
9	Corrente de fuga através do paciente (Condição Normal) Leituras: 3 uA ca 1 uA cc Limites: 100uA ca 10uA cc	Aprovado
10	Corrente de fuga paciente (Condição Normal - Polaridade inversa) Leituras: 2 uA ca 0 uA cc Limites: 100uA ca 10uA cc	Aprovado

Ensaio realizado em condições normais de temperatura e umidade


Padrões Utilizados :

Identificação	Código	Certificado	Validade	Laboratório
Testador de Segurança Elétrica	EL0738	140000036049	01/04/2027	Entran

Signatário Autorizado
Valquíria da Silva Pereira
Central de Recondicionamento de Importados

Item 11 – Memória de eventos
Solicita-se esclarecer quanto à impossibilidade de alteração dos registros armazenados pelo operador assistencial comum.
Resposta: Apenas profissionais qualificados **Técnico de Engenharia Clínica / Administrador** e munidos de senha master ou software de serviço específico de fábrica conseguem realizar manutenções, baixar o log de eventos (o histórico de eventos não zera, ele somente vaia apagando os primeiros para continuar armazenando os 1.000). O manual certifica que o operador comum não consegue limpar a memória do sistema por nenhum comando de interface e nem sequer forçando o desligamento total ou a desenergização do equipamento. O sistema opera de forma automatizada, conforme página 50, no protocolo de histórico.

Item 13.e – Tempo decorrido de infusão
A documentação apresentada demonstra informação em contagem regressiva/tempo remanescente.
Solicita-se esclarecer se o equipamento também dispõe de apresentação de tempo decorrido de infusão.
Resposta: Ao selecionar a tecla “Info**"** e pressionar OK;
As informações abaixo, demonstram que através desta opção é possível ver toda informação da infusão que está ocorrendo. Páigna 35.



- Verifique a plausibilidade dos valores exibidos.
- Se necessário, insira o volume ou tempo.
- Inicie a infusão com a tecla Iniciar/ Parar.

Cálculo usando: Área da superfície do corpo

- Selecione **Área da superfície do corpo** e pressione **OK** para confirmar.
- Insira o peso e pressione **OK** para confirmar.
- Insira a altura do paciente e pressione **OK** para confirmar.
- Selecione a unidade da dose e pressione **OK** para confirmar.
- Insira a dose.
  A taxa será calculada automaticamente.

Observação: Pressionar a tecla OK abre a tela Visão geral.

- Verifique a plausibilidade dos valores exibidos.
- Inicie a infusão com a tecla Iniciar/ Parar.

8.9 Inserção de uma combinação de taxa de administração, volume e tempo

- Linha de infusão inserida e selecionada
- Pressione a tecla **Menu**.
  O menu principal será exibido.
- Selecione **Taxa, volume & tempo** e pressione **OK** para confirmar.
- Insira dois dos parâmetros a seguir e pressione **OK** para confirmar:
  - Taxa
  - Volume
  - Tempo

  O terceiro parâmetro é calculado automaticamente.

Se um ou mais parâmetros forem inseridos, mudar um parâmetro tem os seguintes efeitos sobre os outros parâmetros.

- Taxa (ou taxa de dose) alterada:
  - Se apenas o volume tiver sido inserido, o tempo remanescente será ajustado.
  - Se apenas o tempo tiver sido inserido, o volume remanescente será ajustado.
  - Se o volume e o tempo tiverem sido inseridos, o tempo remanescente será ajustado.
- Volume alterado:
  - Se apenas a taxa tiver sido inserida, o tempo remanescente será ajustado.
  - Se apenas o tempo tiver sido inserido, a taxa (ou taxa da dose) será ajustada.
  - Se a taxa e o tempo tiverem sido inseridos, o tempo remanescente será ajustado.

Item 13.h – Volume total armazenado / balanço hídrico
Solicita-se complementar a comprovação quanto à disponibilização do volume total armazenado / balanço hídrico.
Resposta: A bomba monitora o volume infundido para auxiliar no controle do balanço hídrico do paciente na UTI ou enfermaria. No manual, essa verificação e o ato de reiniciar a contagem (zerar para o próximo plantão) estão descritos no fluxo de navegação da **tecla INFO**.
Como realizar o controle e zerar o balanço:

1. Durante a infusão, pressione a tecla **INFO** no teclado físico do aparelho.
2. A tela mostrará os valores parciais de volume e tempo.
3. Pressione a **seta direcional para baixo** (ou o botão correspondente no rodapé da tela) onde o sistema perguntará se você deseja **zerar o volume acumulado/auxiliar**.
4. Ao confirmar (pressionando a tecla correspondente para cima ou OK), a memória parcial é zerada, iniciando uma nova contagem de volume para o controle do balanço hídrico daquele período ou plantão da enfermagem

Segue vídeo neste link, confimando as informações. E na página 20 em diante está descrito a estrutura do menu/funções do dispositivo.
https://vimeo.com/1014988178/db6f049a6c?share=copy

Item 14.c – Tempo total e/ou decorrido simultaneamente
Solicita-se esclarecer se o equipamento dispõe de apresentação de tempo total e/ou decorrido simultaneamente na tela.
Resposta: No manual, Página 20, os parâmetros de tempo ficam localizados no capítulo **"Estrutura do menu/funções"** (seção do Menu Principal) e na seção **"Descrição do Dispositivo"** (sobre a tela de infusão). O comportamento desses dados na tela funciona da seguinte forma:
1. Programação Simultânea (Menu Principal)
No menu principal, ao acessar **"Taxa, volume & tempo"**, a bomba exibe campos simultâneos para que você veja o cálculo combinado da terapia:

- Se você insere o volume total (VTBI) e a duração da infusão (**Tempo Total**), a bomba exibe e calcula a taxa (ml/h) **simultaneamente na mesma tela** antes de iniciar a infusão.

2. Exibição na Tela Principal Durante a Infusão (Visão Geral)
Quando a infusão está em curso, a tela colorida de "Visão Geral" exibe as variáveis de tempo e volume de forma integrada:

- **Tempo Restante:** É exibido de forma fixa e contínua no rodapé da tela principal durante toda a terapia (representando o tempo que falta para acabar). [1]
- **Tempo Decorrido:** Para visualizar o tempo que **já transcorreu** de forma simultânea com os dados totais, o operador deve pressionar a **tecla INFO**. Na tela de informações, o sistema abre o resumo clínico mostrando o volume injetado, o tempo restante e o tempo que já decorreu desde o início daquela programação.

Item 17 – Registro vigente ANVISA
Solicita-se confirmar formalmente o registro ANVISA correspondente ao modelo ofertado, considerando a divergência identificada entre o registro informado na resposta anterior (80136990889) e a documentação anexada, que identifica o registro 80136990902 para a Infusomat compactplus e o registro 80136990889 para a Perfusor compactplus.
Resposta: O registro 80136990902 para a Infusomat compact plus, conforme página 68 do manual.
Segue link Anvisa do registro:

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351608078201855/?numeroRegistro=80136990902

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	LABORATORIOS B. BRAUN S/A		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	31.673.254/0001-02	**Autorização de Funcionamento da Empresa**	8.01.369-9
Nome do Dispositivo Médico	Infusomat® Compact Plus		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Bomba de infusão		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80136990902		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.608078/2018-55		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: B. BRAUN MELSUNGEN AG - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C009368 - Endereço: CARL BRAUN STRASSE 1, MELSUNGEN – HESSEN - 34212		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05/11/2018		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05/11/2028		

Item 18.k.i – Oclusão distal/proximal + silenciamento
Solicita-se complementar a comprovação quanto à detecção de oclusão distal/proximal e ao respectivo silenciamento.
Resposta: No manual da B. Braun Infusomat Compact Plus, Página 37, os conceitos de oclusão proximal/distal e as regras para o silenciamento de alarmes constam detalhadamente nos capítulos "Operação / Alarmes" e "Sinais de Alarme".
Abaixo está a localização exata e a nomenclatura oficial adotada pelo fabricante para atender aos requisitos de licenciamento ou edital:
1. Oclusão Distal e Proximal (Sensores de Pressão)
Diferente de outros equipamentos que usam os termos em latim ou inglês, o manual traduz essas funções com base na anatomia do circuito do equipo em relação à bomba:

- **Oclusão Proximal (Antes da bomba / Entre o frasco e a bomba):** No manual, esta função é monitorada pelo sensor de entrada e disparada sob o alarme de **"Verificar montagem do equipo"** ou **"Fluxo interrompido a montante"**. Ocorre quando há uma pinça (clamp) fechada acima da bomba ou dobra no tubo que impede o líquido de descer do frasco/bolsa.
- **Oclusão Distal (Depois da bomba / Entre a bomba e o paciente):** No manual, é descrita oficialmente como **"Oclusão do Equipo"** ou **"Alarme de Pressão a Jusante"**. É detectada pelo sensor de pressão inferior (distal) quando há resistência no acesso venoso do paciente, perda de veia ou dobra no equipo abaixo do equipamento. [1, 2]

2. Ao Silenciamento (Regras e Teclas de Alarme)
O comportamento do silenciamento está documentado na seção de **Gerenciamento de Alarmes**. O manual estabelece diretrizes rígidas sobre como silenciar os avisos sonoros:

- **Tecla de Silenciamento (Mute):** Representada fisicamente no teclado pelo símbolo de um alto-falante cortado ou sino. [1]
- **Tempo de Silenciamento Temporário:** Ao pressionar a tecla de silenciamento durante um alarme ativo de oclusão, o som é pausado por exatamente **2 minutos** (tempo padrão para que a enfermagem

resolva a dobra ou obstrução do equipo).

- **Cancelamento Definitivo:** O alarme sonoro e visual só cessa definitivamente quando o operador elimina a causa física da oclusão e pressiona a tecla **OK** para confirmar o reinício da terapia.
- **Recurso de Pré-Alarme:** Na ferramenta de assistência (configurada pela engenharia clínica), o manual menciona a opção de "silenciar permanentemente o pré-alarme" até que ele se torne um alarme de fim de tratamento de fato

Item 18.k.ii – Dose/taxa/bolus acima dos limites da biblioteca
Solicita-se complementar a comprovação quanto à detecção e bloqueio de dose/taxa/bolus acima dos limites da biblioteca, bem como quanto ao silenciamento temporário.
Resposta: Em atenção à solicitação de complementação, declaramos que o equipamento ***Infusomat Compact Plus cumpre integralmente os requisitos solicitados***
Conforme abaixo, a bomba de infusão Compactplus identifica os limites flexível e rígido, através da barra que esta no rodapé da bomba de infusão, impedindo assim que haja uma programação que o usuário possa alegar desconhecimento.
Ressaltando que não há possibilidade alguma de ultrapassar o limite Rigido, que segue as diretrizes do software DERS (Drug Error Reduction System)

Funcionamento

teste, pedindo ao usuário para confirmar se o banco de dados de fármacos deve ser usado.

- Se houver mais de um perfil disponível:
  - Selecione a estação e pressione OK para confirmar.
  - Selecione o perfil do paciente e pressione OK para confirmar.
- Selecione a categoria do medicamento e pressione OK para confirmar.
- Selecione o medicamento e pressione OK para confirmar.
- Se disponível, leia as informações na tela "Informações do medicamento" e pressione OK para confirmar.
- Se necessário, selecione a concentração e pressione OK para confirmar.
- Leia as informações na tela "Medicamento" e pressione OK para confirmar.
- Insira a taxa de administração.
- Inicie a infusão com a tecla Iniciar/Parar.
  - ou
- Confirme a taxa de administração, pressionando OK.
  A tela "Visão geral" será exibida.
- Selecione Vol.//Tempo e pressione OK para confirmar.
- Insira o volume ou o limite de tempo e pressione OK para confirmar.
  Quaisquer valores ainda ausentes serão automaticamente calculados e exibidos.


Observação: Além do volume e do limite de tempo, a taxa de infusão também poderá ser ajustada na tela Visão geral.

- Inicie a infusão com a tecla Iniciar/Parar.

8.7.1 Limites rígidos e flexíveis


Limites rígidos

Limites rígidos são limites fixos para o volume da taxa/dose/bolus e para a taxa de bolus que estão armazenados no banco de dados. Apenas os valores dentro dos limites rígidos podem ser inseridos. Se for feita uma tentativa para exceder ou ficar abaixo do limite rígido, a seguinte mensagem será exibida no visor:



Limites flexíveis

Limites flexíveis para o volume da taxa/dose/bolus e para a taxa de bolus podem, também, ser armazenados no banco de dados. Esses limites podem ser excedidos sem restrições, mas a seguinte mensagem será exibida no visor.



33

Item 18.k.iii – Infusão completa + silenciamento
Solicita-se complementar a comprovação quanto ao silenciamento do alerta de infusão completa.
Resposta: Em cumprimento ao requisito apresentado, declaramos que o equipamento **Infusomat Compactplus atende integralmente ao silenciamento do alerta de infusão completa**. Conforme descrito em seu Manual do Usuário (seção 'Sinais de Alarme' / 'Fim de Infusão'), Página 19, o aviso sonoro decorrente do término do volume programado (VTBI) pode ser pausado temporariamente por **2 minutos** por meio de sua tecla de áudio dedicada ou encerrado permanentemente mediante confirmação com a tecla OK. Adicionalmente, visando a segurança do paciente, o equipamento ativa de forma automatizada a taxa de **KVO (Manter Veia Aberta)** concomitantemente ao disparo do alerta, mantendo a via desimpedida durante o período de atendimento da enfermagem."
Vale ressaltar que a bomba de infusão Compactplus possui a função pré alarme, totalmente configurável que irá avisar ao usuário que a solução está próxima do fim, mantendo neste momento o fluxo programado

Descrição do dispositivo

5.4 Visão geral do visor



Nº	Exibição / Função
1	Setas de movimento: Administração em andamento (a administração parada é mostrada por duas barras)
2	Status da conexão na rede elétrica/da bateria
3	Símbolo de pressão ("manômetro"): Indicação do nível de pressão de P1 a P9 definido com a pressão do sistema atual (ponteiro) Observação: O detector de pressão também está ativo quando o dispositivo está parado ou no modo de espera (Standby).
4	Defina a taxa de administração com a unidade de administração de medicamento
5	Volume já administrado durante a fusão atual
6	Volume remanescente para a infusão atual
7	Tempo remanescente para a infusão atual


5.5 Visor de status do alarme

Os alarmes são exibidos através de uma notificação no display, um sinal sonoro e um LED:

Amarelo: Pré-alarme.
O LED indicador de alarme se acende em amarelo ininterrupto.
Observação: O LED amarelo somente se acende se ativado na ferramenta de assistência



Vermelho: Alarme de funcionamento.
O LED indicador de alarme pisca em vermelho.



- Pressione OK para confirmar o alarme.
- Continue o tratamento ou inicie um novo tratamento.

19

Em anexo segue o manual de Instrução de Uso.

Grata,

De: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Enviado: segunda-feira, 14 de setembro de 2026 09:36
Para: Isaias Santos <isaias.santos@bbraun.com>
Cc: Narjara Bravin <narjara.bravin@bbraun.com>; Lidson Araujo <lidson.carvalho@bbraun.com>; Suporte_Cliente <suporteaocliente@bbraun.com>; Vendas_Digitais_BR <vendasdigitais.br@bbraun.com>; vanessa.paula@bbraun.br <vanessa.paula@bbraun.br>
Assunto: RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Prezados,

Em continuidade à diligência anteriormente encaminhada no âmbito do Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31, referente à Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato, encaminham-se, conforme solicitação da Gerência de Engenharia Clínica, os pontos que permanecem para complementação na proposta da B. Braun – modelo Infusomat compactplus, após análise da documentação apresentada em resposta à diligência anterior:

- **Item 5 – Calibração/validação de fábrica**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto à calibração e/ou validação de fábrica do equipamento.

- **Item 11 – Memória de eventos**
  Solicita-se esclarecer quanto à impossibilidade de alteração dos registros armazenados pelo operador assistencial comum.

- **Item 13.e – Tempo decorrido de infusão**
  A documentação apresentada demonstra informação em contagem regressiva/tempo remanescente.

Solicita-se esclarecer se o equipamento também dispõe de apresentação de tempo decorrido de infusão.

- **Item 13.h – Volume total armazenado / balanço hídrico**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto à disponibilização do volume total armazenado / balanço hídrico.

- **Item 14.c – Tempo total e/ou decorrido simultaneamente**
  Solicita-se esclarecer se o equipamento dispõe de apresentação de tempo total e/ou decorrido simultaneamente na tela.

- **Item 17 – Registro vigente ANVISA**
  Solicita-se confirmar formalmente o registro ANVISA correspondente ao modelo ofertado, considerando a divergência identificada entre o registro informado na resposta anterior (**80136990889**) e a documentação anexada, que identifica o registro **80136990902 para a Infusomat compactplus** e o registro **80136990889 para a Perfusor compactplus**.

- **Item 18.k.i – Oclusão distal/proximal + silenciamento**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto à detecção de oclusão distal/proximal e ao respectivo silenciamento.

- **Item 18.k.ii – Dose/taxa/bolus acima dos limites da biblioteca**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto à detecção e bloqueio de dose/taxa/bolus acima dos limites da biblioteca, bem como quanto ao silenciamento temporário.

- **Item 18.k.iii – Infusão completa + silenciamento**
  Solicita-se complementar a comprovação quanto ao silenciamento do alerta de infusão completa.

Para os itens acima, solicita-se que as respostas sejam acompanhadas da documentação técnica oficial pertinente, com indicação da página do manual e/ou evidência da interface do equipamento.

A manifestação deverá ser encaminhada em resposta a este e-mail, impreterivelmente até 15/09/2026.

Atenciosamente,
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Insumos
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
(61) 3550-8900

De: Isaias Santos <isaias.santos@bbraun.com>
Enviado: terça-feira, 8 de setembro de 2026 15:55
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc: Lidson Araujo <lidson.carvalho@bbraun.com>; Narjara Bravin <narjara.bravin@bbraun.com>
Assunto: RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Boa tarde,

Conforme solicitado segue resposta da Diligência e nosso manual técnico corroborando com o que foi solicitado.

Atenciosamente,

Isaias Santos

Especialista em Vendas Publicas
Telefone: (21) 2602-3223
E-mail: isaias.santos@bbraun.com

Grupo B. Braun
Gerência Operação de Vendas
Vendas Públicas

Laboratórios B Braun S.A.
BBRAUN
Av. Eugênio Borges, 1092 - Arsenal
São Gonçalo – RJ | Brasil
CEP 24751-000

Central de Relacionamento: 0800 227 286 (opção 2)
E-mail: suporteaocliente@bbraun.com
www.bbraun.com.br
www.facebook.com/bbraunbrasil

_____

Como um verdadeiro parceiro, desenvolvemos soluções inteligentes e definimos padrões para impulsionar avanços na área da saúde.

B. Braun - Sharing Expertise

De: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Enviadas: Quinta-feira, 03 de Setembro de 2026 17:15
Para: Vendas_Digitais_BR <vendasdigitais.br@bbraun.com>
Cc: Lidson Araujo <lidson.carvalho@bbraun.com>; Isaias Santos <isaias.santos@bbraun.com>; vanessa.paula@bbraun.br <vanessa.paula@bbraun.br>
Assunto: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Prezado fornecedor,

O **Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF**, por meio do **Núcleo de Compras de Insumos – NCOIN**, no âmbito do **Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31**, referente à **Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato**, solicita a manifestação formal dessa empresa quanto aos apontamentos identificados na avaliação técnica da proposta.

A presente diligência refere-se à Cotação Apoio - **ID 1608597**.

Para tanto, segue **anexa a tabela de avaliação técnica**, na qual estão destacados os itens classificados como **"Não evidenciado — Diligenciar"**.

Solicita-se que essa empresa se manifeste **especificamente quanto aos itens indicados na tabela anexa**, apresentando os esclarecimentos necessários e, quando aplicável, a documentação técnica comprobatória que permita evidenciar o atendimento às respectivas especificações técnicas previstas na contratação.

A manifestação deverá ser objetiva e acompanhada dos documentos pertinentes, quando necessários, para subsidiar a análise da área técnica do IGESDF.

Para consulta aos documentos e informações referentes à seleção de fornecedores, segue o endereço da publicação no sítio eletrônico do IGESDF:
https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-11426-2026-equipos-com-bombas-de-infusao-em-comodato/

A manifestação e eventual documentação complementar deverão ser encaminhadas em resposta a este e-mail, impreterivelmente até o dia 08/09/2026.

Atenciosamente,

Analista de Compras
Núcleo de Compras de Insumos
IGESDF/DALOG/SULOG/GGCOM/NCOIN
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
(61) 3550-8900

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.

Outlook

RE: Diligência - Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

De CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Data Qua, 23/09/2026 15:23
Para fernanda.guedes@lifemed.com.br <fernanda.guedes@lifemed.com.br>
Cc heloise.banares@lifemed.com.br <heloise.banares@lifemed.com.br>; nfusao@lifemed.com.br <infusao@lifemed.com.br>; 'Andre Prada' <andre.prada@lifemed.com.br>; leonardo.reichow@lifemed.com.br <leonardo.reichow@lifemed.com.br>

Prezados,

Referente ao processo de aquisição em andamento e conforme a análise técnica, a área de planejamento solicitou diligência junto aos fornecedores, para que apresentem documentação técnica e/ou declaração formal da empresa fabricante, de forma clara e objetiva, comprovando o atendimento aos requisitos abaixo:

> *À empresa **LIFEMED**, referente à bomba **V-LINK PRO**: apresentar comprovação técnica quanto à existência e funcionamento da biblioteca de fármacos, bem como do mecanismo efetivo de alerta e/ou bloqueio associado aos limites configurados na biblioteca.*

> *Ressalta-se que as respostas deverão ser apresentadas de forma objetiva, acompanhadas, de documentação técnica do fabricante, manuais, fichas técnicas, catálogos ou declaração formal que permita a verificação inequívoca do atendimento aos requisitos estabelecidos.*

A comprovação deverá ser enviada impreterivelmente até o dia 24/09/2026

De: Fernanda Guedes <fernanda.guedes@lifemed.com.br>
Enviado: terça-feira, 15 de setembro de 2026 16:11
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc: infusao@lifemed.com.br <infusao@lifemed.com.br>; heloise.banares@lifemed.com.br <heloise.banares@lifemed.com.br>; 'Andre Prada' <andre.prada@lifemed.com.br>; leonardo.reichow@lifemed.com.br <leonardo.reichow@lifemed.com.br>
Assunto: RES: Diligência - Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Boa Tarde, Prezados (as),

Segue em anexo respostas conforme solicitação evidenciando os pontos destacados abaixo.

Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos que se façam necessários estamos à disposição.

******Por favor, acusar o recebimento deste.***

Fernanda Guedes
Núcleo de Propostas
Tel. 55 11 5564-3232 Ramal:364
fernanda.guedes@lifemed.com.br
www.lifemed.com.br
Rua Castilho 392, 6°Andar
CEP 04568-010 São Paulo - SP

De: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2026 09:15
Para: fernanda.guedes@lifemed.com.br; heloise.banares@lifemed.com.br
Assunto: RE: Diligência - Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Prezados,

Em continuidade à diligência anteriormente encaminhada no âmbito do Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31, referente à Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato, encaminha-se, conforme solicitação da Gerência de Engenharia Clínica, os pontos que permanecem para complementação na proposta da Lifemed – modelo V-LINK PRO, após análise da documentação apresentada em resposta à diligência anterior:

- **Item 13.e** – Tempo decorrido de infusão
  Foi apresentada a informação de "tempo remanescente da terapia"/"tempo restante".
  Solicita-se esclarecer se o equipamento também permite a visualização do tempo decorrido e/ou tempo total da infusão, com a respectiva comprovação técnica.

- **Item 14.c** – Tempo total e/ou decorrido simultaneamente
  Solicita-se esclarecer se o equipamento possibilita a apresentação simultânea do tempo total e/ou decorrido da infusão, juntamente aos demais parâmetros previstos na especificação.

- **Item 18.b** – Volume micro/macro
  Solicita-se comprovar o atendimento às faixas de programação e respectivos incrementos previstos para os modos micro e macro, especificamente para o modelo V-LINK PRO ofertado.

- **Item 18.k.ii** – Limites da biblioteca de medicamentos
  Solicita-se esclarecer se o equipamento identifica e sinaliza especificamente situações em que dose, taxa ou bolus ultrapassem os limites configurados na biblioteca de medicamentos.

Para os itens acima, solicita-se que as respostas sejam acompanhadas da documentação técnica oficial pertinente, com indicação da página do manual e/ou evidência da interface do equipamento.

A manifestação deverá ser encaminhada em resposta a este e-mail, impreterivelmente até 15/09/2026.

Atenciosamente,

Analista de Compras
Núcleo de Compras de Insumos
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
(61) 3550-8900

De: Fernanda Guedes <fernanda.guedes@lifemed.com.br>
Enviado: sexta-feira, 4 de setembro de 2026 14:28
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc: heloise.banares@lifemed.com.br <heloise.banares@lifemed.com.br>; leonardo.reichow@lifemed.com.br <leonardo.reichow@lifemed.com.br>; infusao@lifemed.com.br <infusao@lifemed.com.br>
Assunto: RES: Diligência - Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Boa Tarde, Prezados (as),

Segue em anexo respostas conforme solicitação evidenciando os pontos destacados **Diligenciar** na tabela.

Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos que se façam necessários estamos à disposição.

***Por favor, acusar o recebimento deste.

De: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2026 17:26
Para: nucleo@lifemed.com.br
Cc: fernanda.guedes@lifemed.com.br; heloise.banares@lifemed.com.br
Assunto: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Prezado fornecedor,

O **Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF**, por meio do **Núcleo de Compras de Insumos – NCOIN**, no âmbito do **Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31**, referente à **Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato**, solicita a manifestação formal dessa empresa quanto aos apontamentos identificados na avaliação técnica da proposta.

A presente diligência refere-se à Cotação Apoio - **ID 1608597**.

Para tanto, segue **anexa a tabela de avaliação técnica**, na qual estão destacados os itens classificados como **"Não evidenciado — Diligenciar"**.

Solicita-se que essa empresa se manifeste **especificamente quanto aos itens indicados na tabela anexa**, apresentando os esclarecimentos necessários e, quando aplicável, a documentação técnica comprobatória que permita evidenciar o atendimento às respectivas especificações técnicas previstas na contratação.

A manifestação deverá ser objetiva e acompanhada dos documentos pertinentes, quando necessários, para subsidiar a análise da área técnica do IGESDF.

Para consulta aos documentos e informações referentes à seleção de fornecedores, segue o endereço da publicação no sítio eletrônico do IGESDF:

https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-11426-2026-equipos-com-bombas-de-infusao-em-comodato/

A manifestação e eventual documentação complementar deverão ser encaminhadas em resposta a este e-mail, impreterivelmente até o dia 08/09/2026.

Outlook

RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

De CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Data Qua, 23/09/2026 15:25
Para Rafaela ROCHA <rafaela.rocha@samtronic.com.br>
Cc tatiane.molezim@samtronic.com.br <tatiane.molezim@samtronic.com.br>; aline.nascimento@samtronic.com.br <aline.nascimento@samtronic.com.br>; Setor.Licitacao.SP@samtronic.com.br <setor.licitacao.sp@samtronic.com.br>; marcos@micromedicalsaude.com.br <marcos@micromedicalsaude.com.br>

Prezados,

Referente ao processo de aquisição em andamento e conforme a análise técnica, a área de planejamento solicitou diligência junto aos fornecedores, para que apresentem documentação técnica e/ou declaração formal da empresa fabricante, de forma clara e objetiva, comprovando o atendimento aos requisitos abaixo:

> *À empresa **SAMTRONIC**, referente à bomba **ICATU S 4.0 INTELLI Wi-Fi**: considerando os questionamentos relacionados ao silenciamento temporário de determinados eventos, incluindo KVO e bateria baixa, bem como a existência de mecanismos de proteção vinculados aos limites da biblioteca de medicamentos e à preservação dos alarmes de segurança, solicitamos esclarecer o comportamento do equipamento quanto ao silenciamento desses alertas, especificando quais alarmes podem ser silenciados, por quanto tempo e quais permanecem ativos, bem como as diferenças de funcionamento entre os alertas de KVO e bateria baixa, de modo a confirmar que o recurso de silenciamento não compromete a segurança do paciente nem interfere nos mecanismos de proteção da bomba.*

> *Ressalta-se que as respostas deverão ser apresentadas de forma objetiva, acompanhadas, de documentação técnica do fabricante, manuais, fichas técnicas, catálogos ou declaração formal que permita a verificação inequívoca do atendimento aos requisitos estabelecidos.*

A comprovação deverá ser enviada impreterivelmente até o dia 24/09/2026

Atenciosamente,

De: Rafaela ROCHA <rafaela.rocha@samtronic.com.br>
Enviado: terça-feira, 15 de setembro de 2026 16:14
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc: Tatiane MOLEZIM <tatiane.molezim@samtronic.com.br>; Aline NASCIMENTO <aline.nascimento@samtronic.com.br>; Setor.Licitacao.SP <Setor.Licitacao.SP@samtronic.com.br>; MICROMEDICAL Marcos <marcos@micromedicalsaude.com.br>
Assunto: RES: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Prezados, boa tarde a todos.

Segue em anexo, documento em relação as diligências solicitadas.

Atenciosamente,
Rafaela Rocha - Assistente de Licitação
rafaela.rocha@samtronic.com.br

+55 11 2244-7789
www.samtronic.com.br



AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.

LEGAL NOTICE: This message, including its attachments, is confidential and its content is restricted to the message recipient. If you have received this message in error, please return it to the recipient and delete it from your files. Any unauthorized use, replication or dissemination of this message or part thereof is expressly prohibited

---

De: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2026 09:45
Para: Rafaela ROCHA <rafaela.rocha@samtronic.com.br>
Cc: Tatiane MOLEZIM <tatiane.molezim@samtronic.com.br>; Aline NASCIMENTO <aline.nascimento@samtronic.com.br>; Setor.Licitacao.SP <Setor.Licitacao.SP@samtronic.com.br>; MICROMEDICAL Marcos <marcos@micromedicalsaude.com.br>
Assunto: RE: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Prezados,

Em continuidade à diligência anteriormente encaminhada no âmbito do Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31, referente à Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato, encaminham-se, conforme solicitação da Gerência de Engenharia Clínica, os pontos que permanecem para complementação na proposta da Samtronic – modelo ICATU S 4.0 INTELLI Wi-Fi, após análise da documentação apresentada em resposta à diligência anterior:

- **Item 11** – Memória ≥ 1.000 eventos e impossibilidade de alteração
  Solicita-se apresentar confirmação expressa de que os registros armazenados não podem ser alterados ou excluídos pelo operador assistencial comum.

- **Item 18.b** – Volume micro/macro
  Solicita-se esclarecer o atendimento integral às faixas e aos incrementos estabelecidos para os modos micro e macro pelo modelo especificamente ofertado, considerando que o Manual do Usuário apresenta distinções entre os modelos integrantes da família ICATU 4.0.

- **Item 18.k.ii** – Dose/taxa/bolus acima dos limites da biblioteca
  Solicita-se confirmar objetivamente a disponibilidade de silenciamento temporário para os eventos de dosagem incorreta.

- **Item 18.k.iv** – KVO + silenciamento
  Solicita-se confirmar objetivamente a disponibilidade de silenciamento temporário para os eventos relacionados ao funcionamento em KVO.

- **Item 18.k.v** – Bateria baixa + silenciamento
  Solicita-se confirmar objetivamente a disponibilidade de silenciamento temporário para os eventos relacionados ao nível baixo de carga da bateria.

Para os itens acima, solicita-se que as respostas sejam acompanhadas da documentação técnica oficial pertinente, com indicação da página do manual e/ou evidência da interface do equipamento.

A manifestação deverá ser encaminhada em resposta a este e-mail, impreterivelmente até 15/09/2026.

Para processos futuros, quanto à atualização dos endereços de e-mail, sugere-se que a empresa realize a alteração diretamente na plataforma Apoio Cotações, tendo em vista que este Núcleo não possui acesso para retificação dos dados cadastrais dos fornecedores na referida plataforma.

Atenciosamente,
Núcleo de Compras de Insumos
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
(61) 3550-8900

De: Rafaela ROCHA <rafaela.rocha@samtronic.com.br>
Enviado: terça-feira, 8 de setembro de 2026 15:14
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc: Tatiane MOLEZIM <tatiane.molezim@samtronic.com.br>; Aline NASCIMENTO <aline.nascimento@samtronic.com.br>; Setor.Licitacao.SP <Setor.Licitacao.SP@samtronic.com.br>; MICROMEDICAL Marcos <marcos@micromedicalsaude.com.br>
Assunto: RES: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Prezados, boa tarde a todos.

Segue em anexo, comprovação das diligências solicitadas.

Fico à disposição,

Atenciosamente,

Rafaela Rocha - Assistente de Licitação

rafaela.rocha@samtronic.com.br

+55 11 2244-7789

www.samtronic.com.br



AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.

LEGAL NOTICE: This message, including its attachments, is confidential and its content is restricted to the message recipient. If you have received this message in error, please return it to the recipient and delete it from your files. Any unauthorized use, replication or dissemination of this message or part thereof is expressly prohibited

De: Aline NASCIMENTO <aline.nascimento@samtronic.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2026 06:52
Para: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>; Setor.Licitacao.SP <Setor.Licitacao.SP@samtronic.com.br>
Cc: Tatiane MOLEZIM <tatiane.molezim@samtronic.com.br>
Assunto: RES: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31
Prioridade: Alta

Bom dia a todos!

@CX - COMPRAS MATERIAIS

Confirmo o recebimento do e-mail e informo que os e-mails corretos para envio são setor.licitacao.sp@samtronic.com.br e tatiane.molezim@samtronic.com.br , pois a Jandira e a Cynthia não fazem mais parte do quadro de colaboradores da Samtronic.

@Setor.Licitacao.SP

Por favor, verificar o e-mail abaixo.

Atenciosamente,

Aline Nascimento - Coordenadora Comercial

aline.nascimento@samtronic.com.br

+55 (11) 2244-7714

www.samtronic.com.br



AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.

LEGAL NOTICE: This message, including its attachments, is confidential and its content is restricted to the message recipient. If you have received this message in error, please return it to the recipient and delete it from your files. Any unauthorized use, replication or dissemination of this message or part thereof is expressly prohibited

---

De: CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2026 17:17
Para: JANDIRA.OLIVEIRA@SAMTRONIC.COM.BR
Cc: Setordelicitacoes@samtronic.com.br; Cynthia CONCEICAO <cynthia.conceicao@samtronic.com.br>
Assunto: Diligência – Avaliação Técnica | ID 1608597 | Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31

Geralmente, você não recebe emails de compras.materiais@igesdf.org.br. Saiba por que isso é importante

Prezado fornecedor,

O **Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF**, por meio do **Núcleo de Compras de Insumos – NCOIN**, no âmbito do **Processo SEI nº 04016-00073117/2026-31**, referente à **Solicitação de Compras nº 11426/2026 – Materiais Médico-Hospitalares (Equipos) com Bomba de Infusão em Comodato**, solicita a manifestação formal dessa empresa quanto aos apontamentos identificados na avaliação técnica da proposta.

A presente diligência refere-se à Cotação Apoio - **ID 1608597**.

Para tanto, segue **anexa a tabela de avaliação técnica**, na qual estão destacados os itens classificados como **"Não evidenciado — Diligenciar"**.

Solicita-se que essa empresa se manifeste **especificamente quanto aos itens indicados na tabela anexa**, apresentando os esclarecimentos necessários e, quando aplicável, a documentação técnica comprobatória que permita evidenciar o atendimento às respectivas especificações técnicas previstas na contratação.

A manifestação deverá ser objetiva e acompanhada dos documentos pertinentes, quando necessários, para subsidiar a análise da área técnica do IGESDF.

Para consulta aos documentos e informações referentes à seleção de fornecedores, segue o endereço da publicação no sítio eletrônico do IGESDF:

https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-11426-2026-equipos-com-bombas-de-infusao-em-comodato/

A manifestação e eventual documentação complementar deverão ser encaminhadas em resposta a este e-mail, impreterivelmente até o dia 08/09/2026.

Atenciosamente,

Analista de Compras

Núcleo de Compras de Insumos

Despacho - IGESDF/DALOG/SULOG/GGCOM/NCOIN

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

(61) 3550-8900